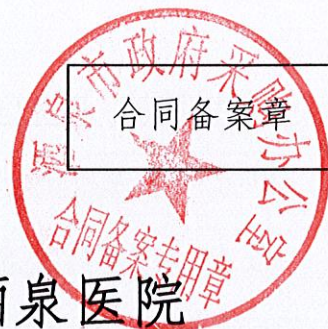




上海市第一人民医院酒泉医院

(酒泉市人民医院) 医疗设备更新项目

(二标段) (一包)

合 同

合同备案号: 2024HTBA00329

项目编号: JQZFCG-2024-1152 号

监督单位: 酒泉市政府采购办公室

采购单位: 上海市第一人民医院酒泉医院 (酒泉市人民医院)

中标单位: 甘肃药业集团三元医药有限公司

代理机构: 甘肃博闻正信项目咨询有限公司

签订日期: 2024 年 12 月



合同主要条款

项目编号：JQZFCG-2024-1152 号

甲方：上海市第一人民医院酒泉医院（酒泉市人民医院）

乙方：甘肃药业集团三元医药有限公司

上海市第一人民医院酒泉医院（酒泉市人民医院）委托甘肃博闻正信项目咨询有限公司在甘肃政府采购网、酒泉市公共资源交易网发布招标公告，于 2024 年 12 月 24 日在酒泉市公共资源交易中心开标室采用公开招采的方式进行招采，确定甘肃药业集团三元医药有限公司为上海市第一人民医院酒泉医院（酒泉市人民医院）医疗设备更新项目（二标段）（一包）的中标单位，甲乙双方经协商，就项目数量、质量、价格、售后服务、保障措施等相关内容，并达成以下条款：

第一条：项目名称、报价明细表及价格

1.项目名称：上海市第一人民医院酒泉医院（酒泉市人民医院）医疗设备更新项目（二标段）（一包）

2. 采购内容：

序号	设备名称	单位	数量	备注
1	数字减影血管造影床 （悬吊式）	套	1	包含配套安装， 详见技术要求

3. 报价表：

序号	名称	品牌	规格 型号	生产 厂家	数量 （台/ 套）	单价 （元）	总价 （元）
1	数字减影 血管造影 床（悬吊 式）	飞利浦	Azurion 5M20	飞利浦医疗 （苏州）有限 公司	1 套	6980000	6980000

4. 合同总价款：小写：¥6980000.00 元（人民币大写：陆佰玖拾捌万元整）。

该合同总价款包括设备、仓储、运输、安装、验收及质保期间发生的一切费用。

第二条：甲方与乙方

甲方为上海市第一人民医院酒泉医院（酒泉市人民医院），在《合同》中所述各处甲方（或采购人）均为上海市第一人民医院酒泉医院（酒泉市人民医院）。

乙方为甘肃药业集团三元医药有限公司，在《合同》中所述各处乙方（或中标单位）均为甘肃药业集团三元医药有限公司。

1. 甲方的权利和义务：

（1）甲方全权负责项目实施中的协调及质量监管工作。

（2）为乙方提供项目实施场所及相关资料，负责本项目实施期间的协调工作，审查乙方提供的设计单位及施工单位相关资质、实施方案及进度计划。

（3）负责对本项目服务质量的控制、检验。

（4）甲方将不定期地对乙方执行项目情况进行检查。

2. 乙方的权利和义务：

（1）乙方全权负责本项目的实施组织；

（2）乙方负责按《招标文件》中招标内容要求和相关技术规范严格实施，确保质量和进度。

（3）乙方须提供设计单位及施工单位相关资质。

（4）乙方须严格按照招标文件售后服务条款约定实施，以达到设备安装条件。

(5) 乙方应随时接受甲方管理人员的检查，对不符合质量标准的应及时返工，其费用及因延误工期造成的损失由乙方承担。

第三条：质量和项目技术要求

(详见《招标文件》中招标内容并附的详细规格与参数)

第四条：项目完成期限及交付地点

1. 项目完成期限：乙方必须在签定合同之日起 30 日内完成中标项目的施工、供货及验收等工作。

2. 交付地点：上海市第一人民医院酒泉医院（酒泉市人民医院）新院区 1 号楼 4 层介入中心 3 号机房

第五条：项目验收

乙方在完成本项目全部内容后起在 7 个工作日内，按采购内容要求，甲、乙双方组织有关人员进行初步验收。

初步验收合格后由甲方通知本项目招标代理机构，组织项目评审专家进行全面验收。

甲方在验收中发现不符合合同要求和验收标准或有疑议时，应通知乙方，乙方在接到通知 3 个工作日内给与答复并负责处理，若需要送至有关部门检验，检验费由乙方承担，如有发现严重不符合质量要求，甲方有权通知乙方停止服务项目。

项目验收合格前，合同标的物的灭失、损毁等风险由乙方承担。

第六条：合同款的支付

付款方式及步骤：合同签订后，支付 70%（即¥4886000.00 元，人民币大写：肆佰捌拾捌万陆仟元整），经安装、调试、双方验收合格后支付 20%（即¥1396000.00 元，人民币大写：壹佰叁拾玖万陆仟元整），剩余 10%（即¥698000.00 元，人民币大写：陆拾玖万捌仟

元整) 五年内付清。

乙方在所提供的所有服务全部完成后经甲方验收合格后, 向甲方提供如下单据: (1) 合同复印件。(2) 按《合同》总价款、验收报告开具的发票(完税价); (3) 采购人加盖公章证明服务项目按要求完成并验收合格的验收单; (4) 所有付款凭据电子扫描件。

第七条: 质量保证

1. 所有设备设施及附属材料必须是国家认证的合格产品。

2. 所有设备设施及附属材料必须符合国家质量检测标准, 保证技术指标先进, 质量可靠; 进场后需接受甲方检验, 经甲方同意后方可入场使用。

3. 必须符合《招标文件》中的各项要求。

4. 乙方提供的所有合同标的物必须是所有权无争议, 且不侵犯第三方的知识产权。

第八条: 履约延误

1. 乙方须严格按照合同约定执行。

2. 在履行《合同》过程中, 乙方如果可能遇到妨碍按时完成项目的情况时, 应及时将延期的事实、可能延期的期限和理由书面通知采购人。采购人在收到乙方通知后, 应尽快对情况进行评价, 并确定是否同意延长合同完成的时间或延期提供服务。

3. 乙方如无正当理由而拖延合同完成的时限, 将受到以下制裁: 收取误期违约金或终止合同。乙方逾期未完成合同项目, 每逾期一日提交人民币 ¥5000.00 元 (人民币大写: 伍仟元整) 作为违约金, 逾期时间超过三十日甲方有权单方面终止该合同。因逾期对甲方造成的损失由乙方承担。

第九条：争议的解决

甲乙双方就项目内容、质量、售后服务、保障措施等出现异议时，应先通过友好协商形式解决，如协商仍不能解决，可以向酒泉市政府采购办公室提请调解。调解不成，任何一方有权在签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十条：其他约定

1. 认真遵守职业道德和行业规范，严格执行财经纪律，坚决杜绝送礼品、给回扣、报销费用等一切不正当竞争行为。

2. 乙方对中标项目建立供货档案，记录项目执行过程中全部执行情况，并及时负责向甲方提供的项目执行过程中执行情况的报告。

3. 乙方应在施工过程中应有必要的安全措施并保证安全实施，若出现安全问题由乙方承担全部责任。

4. 采购人及其人员，不得假借政府采购之名为其他单位或个人向乙方提出超越合同范围的其他要求，如有违反，酒泉市政府采购办将依照《政府采购法》等有关法规对其进行处罚。

第十一条：违约终止

1. 在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可在下列情况下向乙方发出书面通知书，提出终止部分或全部。

(1) 乙方不遵守国家法律法规规定和服务承诺标准；

(2) 乙方没有按承诺的时间或甲方同意延长限期内完成项目内容及要求或提供其他服务；

(3) 乙方没有按承诺的价格签订合同；

(4) 乙方无故不按照甲方要求完成项目内容的；

(5) 乙方在收到甲方发出违约通知后 20 天内，或经甲方书面同

意延长的时间内未能纠正其过失；

(6) 违反本合同中规定或承诺的其他情形。

第十二条：破产终止

乙方如果丧失履约能力或被宣布破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。该终止采购将不损害或影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

第十三条：转让和分包

除甲方事先书面同意外，乙方不得转让和分包其履行的合同义务。如乙方擅自转让和分包且不履行其合同义务，甲方有权终止与乙方的合同，由此造成的一切后果由乙方全部承担。

第十四条：合同生效

1. 下列文件与本合同具有同等法律效力：

(1) 甲方招标文件（编号：JQZFCG-2024-1152 号）；

(2) 乙方投标文件；

(3) 投标报价表、保障措施、售后服务及相关承诺等；

如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2. 本合同经甲乙双方签字并加盖公章后生效。

3. 本合同一式捌份，具有同等法律效力。甲方执肆份、乙方执贰份、招标代理公司执壹份、酒泉市政府采购办壹份。

第十五条：合同修改

除了双方签署书面修改合同或补充合同，并成为本合同不可分割的一部分。本合同条件不得有任何变化或修改。

第十六条：合同附件

附件一：服务要求

附件二：技术参数明细

附件三：服务承诺书（包含安全文明施工条款）

附件四：原厂五年质保承诺书

附件五：中标通知书

需 方（甲方）

供 方（乙方）

单 位 名称：上海市第一人民医院酒泉医院（酒泉市人民医院）

单 位 名称：甘肃药业集团三元医药有限公司

地 址：甘肃省酒泉市肃州区风电大道9号

地 址：甘肃省兰州市城关区广武门街道秦安路184号第6层601-603、606、608、610室

统一社会信用代码：

开户银行：兰州银行酒泉分行营业部

1262210043845017X4

银行账号：101812001377189

法定代表人或委托代理人：

法定代表人或委托代理人：

电 话：0937-6982661

电 话：17352278513

签订日期：2024年12月30日

签订日期：2024年12月27日

签约地点：上海市第一人民医院酒泉医院（酒泉市人民医院）

附件一：售后及服务要求

（一）售后服务要求：

★1. 原厂全保 ≥ 5 年（含球管、平板探测器及第三方配套设备，并提供原厂5年质保承诺书及证明文件）。

2. 供货期及安装不能超过30天，售后响应时间7 $\times$ 24小时。

3. 2次培训，每次5天，为医院技术医师、设备技师、护士长、护士等技术团队提供医院内现场培训，培训内容包括机器本身操作和应用及高级临床应用培训。3-4人省内及省外学习。

（二）服务要求：

1. 提供所投产品5年的免费上门保修，终身维修。保修期内免费更换零配件，免费线上线下技术支持服务，在接到正式通知后2小时内响应，48小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过72小时。保修期自验收合格之日起计算。

2. 提供所投产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

附件二：技术参数明细

设备技术参数	
功能介绍	满足心、脑、周围血管的造影和介入治疗需要
★功率参数	高压发生器功率： $\geq 100\text{KW}$ 最大管电流： $\geq 1000\text{mA}$ 逆变频率： $\geq 100\text{kHz}$ 最小管电压： $\leq 40\text{KV}$ 最大管电压： $\geq 125\text{KV}$
机架	
技术参数 1	悬吊式机架
技术参数 2	机架可进行等中心旋转
技术参数 3	机架运动包括电动和手动两种方式
技术参数 4	C 型臂旋转速度（非旋转采集）LAO/RAO： $\geq 25^\circ / \text{秒}$
技术参数 5	C 型臂环内滑动速度（非旋转采集）CRAN/CAU： $\geq 25^\circ / \text{秒}$
技术参数 6	CRA： $\geq 90^\circ$
技术参数 7	CAU： $\geq 90^\circ$
技术参数 8	RAO： $\geq 180^\circ$
技术参数 9	LAO： $\geq 120^\circ$
技术参数 10	旋转采集角度 $\geq 200^\circ$
技术参数 11	床旁可以单手柄控制、操作 C 型臂机架的运动
技术参数 12	C 臂的旋转角度：C 臂检查摆位无死角，C 臂旋转至任何角度均可投照
技术参数 13	C 型臂弧深： $\geq 90\text{cm}$ （不包括 L 臂补偿）
技术参数 14	等中心到焦点距离： $\geq 75\text{cm}$
导管床	
技术参数 15	满足全身检查、治疗的要求

技术参数 16	床面要求为碳纤维材料
技术参数 17	具有进行 CPR 功能
技术参数 18	纵向运动范围： $\geq 120\text{cm}$
技术参数 19	导管床横向运动： $\geq 35\text{cm}$
技术参数 20	床面升降范围： $\geq 28\text{cm}$
技术参数 21	床面最低高度： $\leq 78\text{cm}$
技术参数 22	床最大承重： $\geq 325\text{KG}$
技术参数 23	床长度： $\geq 280\text{cm}$
技术参数 24	床面旋转角度： ≥ 240 度
检查室内控制系统	
技术参数 25	床旁控制系统
X 线球管	
技术参数 26	球管阳极散热率： $\geq 5500\text{W}$
技术参数 27	球管焦点： ≥ 2 个
技术参数 28	小焦点： $\leq 0.4\text{mm}$
技术参数 29	大焦点： $\leq 1.0\text{mm}$
技术参数 30	液态金属轴承球管
技术参数 31	球管内置多档金属滤片
平板探测器	
▲技术参数 32	探测器类型： ≥ 16 bits 非晶硅数字化平板探测器
技术参数 33	最大有效成像视野(边长) $\geq 30\text{cm} \times 38\text{cm}$
技术参数 34	≥ 6 种物理成像视野，以适应不同部位介入需要
技术参数 35	最大图像矩阵灰阶输出： $\geq 1904 \times 2480 \times 16$ bits
技术参数 36	平板探测器分辨率： $\geq 3.25\text{LP/mm}$
技术参数 37	像素尺寸： $\leq 154\mu\text{m}$
技术参数 38	0.1p/mm 时 DQE： $\geq 77\%$
技术参数 39	平板探测器带有非接触式防碰撞保护装置及防碰撞自动控制

图像显示器	
技术参数 40	控制室：≥24 英寸医用高分辨率 LCD 显示器，≥2 台，显示矩阵：≥1920 x 1080
技术参数 41	手术室：≥27 英寸医用高分辨率 LCD 显示器，≥4 台，显示矩阵：≥1920 x 1080
技术参数 42	≥4 架位宽屏显示器吊架
技术参数 43	显示器吊架可置于床旁三侧位置
技术参数 44	显示器吊架可进行人性化电动升降
技术参数 45	显示器吊架可旋转
技术参数 46	显示器上可显示 X 线使能、球管温度、曝光的 kV, mA 及 ms、机架的旋转和成角信息、导管床高度、探测器视野、系统通用提示信息、选择的帧率、透视模式、累计透视时间、剂量率、累计剂量、DAP 剂量面积乘积
图像系统	
技术参数 47	外周采集、处理、存储 20482 矩阵
技术参数 48	心脏采集、处理、存储 10242 矩阵
技术参数 49	实时减影
技术参数 50	脉冲透视
技术参数 51	床旁可直接选择透视剂量：≥3 档
技术参数 52	具有透视末帧图像保持功能
技术参数 53	硬盘图像存储量 1024 矩阵≥50,000 幅
技术参数 54	最大脉冲透视速度：≥30 幅/秒
技术参数 55	影像数据可从主机在后台向工作站/PACS 系统自动、连续、快速传递，前台透视、采集曝光不受干扰

技术参数 56	后处理功能包括：改变回放速度、选择路标图像、电子遮光器、边缘增强、图像反转、附加注解、快速选择图像、移动放大、可变速度循环放映、造影图像自动窗宽、窗位调节、重定蒙片、手动自动像素移位、最大路径和骨标记
技术参数 57	血管序列实时 DSA 功能和 DA 功能
技术参数 58	图像显示功能：采集时间、日期显示、图像冻结，灰阶反转，图像标注，左 / 右标识，文字注释，解剖背景。
技术参数 59	路径图造影剂自动峰值保持功能
技术参数 60	支持术中事件记录并存储
技术参数 61	微剂量功能
技术参数 62	具备专用剂量降低使用的计算机硬件系统
技术参数 63	自动和实时运动补偿
技术参数 64	旋转采集
技术参数 65	L 臂旋转采集 C 臂旋转速度：≥55 度/秒，有效覆盖范围：≥200 度
技术参数 66	1024 采集，最快采集速度：≥30 幅/秒
技术参数 67	可实时减影
技术参数 68	网络与接口
技术参数 69	具有 DICOM Send 功能
技术参数 70	具有 DICOM Print 功能
技术参数 71	具有 DICOM Query/Retrieve 功能
技术参数 72	具有 DICOM Worklist 功能
技术参数 73	具有 DICOM MPPS 功能
技术参数 74	激光相机接口
技术参数 75	高压注射器接口
技术参数 76	附件

技术参数 77	双向对讲系统
技术参数 78	图像处理操作面板
技术参数 79	红外遥控器 2 个
技术参数 80	悬吊式射线防护屏
技术参数 81	床旁射线防护帘
技术参数 82	悬吊式手术灯
技术参数 83	中文操作手册
技术参数 84	双侧臂托一对
技术参数 85	头托
技术参数 86	桡动脉穿刺臂托
技术参数 87	多功能脚闸
技术参数 88	智能路图功能
技术参数 89	可针对脑血管、胸部、腹部等不同检查部位，设置专门的路图参数，并可在床旁液晶触摸屏上直接进行参数调整
技术参数 90	可在床旁液晶触摸屏上选择针对导管引导、打胶、放置弹簧圈等不同介入操作的专门路图模式
技术参数 91	医生可自定义针对特殊介入操作类型的路图显示模式
技术参数 92	在不同路图模式下，可对路图中的减影血管影像、介入植入物（导丝导管、胶、弹簧圈等）、解剖背景的亮度进行分别的独立调节，以满足复杂介入操作引导的需要
技术参数 93	液晶触摸屏上具有专门的路图运动伪影自动消除键，可随时对由于病人微小运动导致的路图伪影进行自动实时补偿校正，有效减少运动伪影的影响
技术参数 94	蒙片优化功能

技术参数 95	可对用于实时 DSA 的蒙片数量进行实时组合优化,以明显降低蒙片的背景噪声,显著提高 DSA 的图像质量
技术参数 96	可对用于实时 DSA 的蒙片数量进行实时组合优化,在保持相同噪声水平的前提下,明显降低辐射剂量
技术参数 97	在实时 DSA 图像显示前的瞬间,可显示组合蒙片图像
技术参数 98	可针对不同检查部位进行蒙片数量的个性化组合,以满足不同部位的成像特点
技术参数 99	射线剂量管理系统:
技术参数 100	透视冻结图像上可实现无射线调节遮光器、滤波片位置
技术参数 101	具有射线剂量监测功能,透视时,表面剂量率显示;透视间期,显示积累剂量,区域剂量和剂量限值
技术参数 102	在 SID 改变,手术床水平移动以及垂直升降时均可实现实时追踪手术视野的无射线下视野定位功能。
技术参数 103	支持床旁触摸屏实现无射线下定位
★技术参数 104	配有三维采集重建后处理工作站及软件
技术参数 105	配置床旁触摸屏可显示三维影像,并可进行相应图像处理
技术参数 106	具有多种重建模式数量
技术参数 107	可在床旁触摸屏上实现多曲面重建,3D 两点间测量等功能
技术参数 108	机架可在头位及侧位进行三维采集
技术参数 109	具有体积/表面重建,最大密度投影、模拟机架位、透明血管成像功能
技术参数 110	具备虚拟内窥镜功能
▲技术参数 111	具有类 CT 软组织成像功能

技术参数 112	能提供原厂类 CT 的软组织图像，能够进行机架正位和侧位的类 CT 采集，以满足头部、胸部、腹部、盆腔、脊柱、四肢部分的采集和重建
技术参数 113	类 CT 图像采集，实现全流程实时逐步引导功能
技术参数 114	三维重建和类 CT 重建硬件一体化设计，方便实现二者融合匹配显示
技术参数 115	旋转采集数据能够自动传输至工作站并自动重建，整个过程无需人为参与
技术参数 116	具有专用的金属伪影消除采集程序，消除金属植入物和支架的影响
技术参数 117	具有专用的 BMI 噪声抑制程序
技术参数 118	具有颅内支架精晰显影功能
技术参数 119	具有类 CT 成像功能
技术参数 120	血管导航功能
技术参数 121	具有分割引导工具，无需 CTA 或 MRI 工作站的后处理，可在 DSA 三维后处理工作站进行 CTA 或 MRI 的 DICOM 图像的一键血管提取、分割，并进行 3D 血管标记
技术参数 122	具备 CTA 和 MRI 的血管影像与实时透视图像融合功能
技术参数 123	具备术中手动调整骨性标志与实时透视图像的位置功能
技术参数 124	具备手术计划功能，标记血管穿刺部位，对血管入口及终端的位置进行三维环形标记
技术参数 125	具有高级图像后处理工作站
技术参数 126	主机系统具有心脏分析软件，可测量心室功能等

附属设备及配件
要求

▲（一）配有防护用品必须采用进口材料或进口产品，除眼镜、手套（ ≥ 0.25 铅当量）外其他防护用品必须达到 ≥ 0.5 铅当量，分体式铅衣 6 套，铅橡胶围裙 6 件、铅大领围脖 6 件、铅防护眼镜 6 件（与使用科室沟通配备）、铅防护面屏 6 个，介入防护手套 6 件（与使用科室沟通配备）、移动铅防护屏风 2 个、铅悬挂防护屏/铅防护帘 1 个、床侧防护帘/床侧防护屏 1 个、铅橡胶性腺防护围裙（方形）或方巾 2 件、铅橡胶颈套 2 件、铅橡胶帽子 6 件、铅防护衣专用衣架 2 件、铅衣专用消毒柜 1 个（单次消毒 ≥ 10 件）。

▲（二）配有图像工作站 1 台（CPU4 核，单核处理速度 3.0G 以上，内存 32G 以上，显存 12G 以上，硬盘容量 5TB，显示器 27 寸以上），专用激光打印机 1 台，操作台面（根据机房大小定制），配有谈话工作站 1 套，谈话桌 1 张（根据谈话间大小定制），可升降椅 5 套（符合人体工学设计），配有 55 寸显示屏 2 台。

▲（三）操作间、工作室、机房、更衣室、淋浴间（配有热水器）按国家防护标准进行防护装修装饰以及房屋、水电暖、设备电缆、氧气设备带改造全部由中标供应商承担并完成交钥匙工程。

▲（四）机房必须配有放射防护在线监测设备系统设备 1 套，中标供应商须承担设备与医院 HIS、PACS 等系统的接口费用。

	▲（五）房屋必须进行职业病危害放射防护预、控评及辐射环评验收，并取得相应批复文件。 ▲（六）配备单筒高压注射器一套、心内专用便携式彩超1台（配3把探头）、除颤仪一套、配有双通道有创监护仪2台（图像可传输至控制间）、多导心脏电生理仪一套、吸顶式等离子空气消毒机（数量必须满足房屋面积院感要求）、悬挂式空气消毒机1个、10人组消毒鞋柜、普通衣柜6人。 ▲（七）带有新风功能$\geq 5P$空调1台套，$\geq 5P$空调1台，$\geq 3P$空调1台。 ▲（八）单臂吊塔一组
培训及售后服务要求	★1. 原厂全保≥ 5年（含球管、平板探测器及第三方配套设备，并提供原厂5年质保承诺书及证明文件）。 2. 供货期及安装不能超过30天，售后响应时间7$\times$24小时。 3. 2次培训，每次5天，为医院技术医师、设备技师、护士长、护士等技术团队提供医院内现场培训，培训内容包括机器本身操作和应用及高级临床应用培训。3-4人省内及省外学习。

附件三：服务承诺书（包含安全文明施工条款）

售后服务承诺；

为了给贵院提供优质的售后服务，承诺承诺以下事项：

1. 质保期内：

1、承诺提供所投产品 5 年的免费上门保修，终身维修。保修期自验收合格之日起计算。保修期内免费更换零配件（含球管、平板探测器），提供 7*24 小时免费线上和 12 小时到场的线下技术支持服务，在接到正式通知后 5 分钟内响应，12 小时 内到达现场进行检修，若遇需制造商工程师解决的重大故障，工程师 12 小时内到达现场，解决问题时间不超过 24 小时。

2、承诺拥有一支专业的技术支持团队，能够提供专业的咨询和解决方案，确保采购方的问题得到及时有效的解决。产品制造商服务机构情况，包括地址、联系方式及技术人员数量等。

联系方式：800-810-0038/18919966198

地址：西安市雁塔区二环南路西段 64 号凯德广场 11 楼

投标人本项目服务人员情况表

人员分工	职务	姓名	职称	常住地	资格证明（附原件彩色扫描件）			
					证书名称	级别	证号	专业
项目经理	项目经理	刘晓雄	/	兰州	/	/	/	/
维保服务工程师	维保服务工程师	许永华	/	兰州	IGT2EL001	/	IGT2EL001	DSA 维保
维保服务工程师	维保服务工程师	何飞	/	兰州	WE6027PH	/	WE6027PH	DSA 维保
安装服务经理	安装服务经理	叶勃	/	兰州	/	/	/	DSA 安装协调



3、承诺定期对采购方进行回访，了解产品的使用情况，收集采购方的反馈和建议，以便不断改进承诺的产品和服务。

4、承诺确保提供充足的备件供应，以便在产品出现故障时，能够快速更换损坏的部件，减少采购方的停机时间。

5、承诺提供产品使用培训服务，帮助采购方更好地了解 and 掌握产品的使用方法，提高采购方的使用效率。

6、承诺提供 7*24 小时远程支持服务，通过电话、邮件、视频等方式，为采购方提供远程技术支持和故障排除。

7、承诺关注采购方的需求和体验，积极回应采购方的反馈和建议，不断提升采购方满意度。承诺不断收集采购方反馈，持续改进承诺的售后服务流程，提高服务质量和效率。

8、承诺严格遵守保密协议，保护采购方的商业秘密和个人隐私。

9、投诉处理：承诺设立专门的投诉处理渠道，及时处理采购方的投诉，确保采购方的权益得到保护。

10、承诺定期进行采购方满意度调查，了解采购方对承诺服务的评价，以便不断优化承诺的服务。

11、我方承诺承担本次采购设备与采购方 HIS、PACS 等系统的接口费用。

12、设备等电位地线由我方负责连接，所有费用由我方承担。

13、承诺提供现场 2 次技术培训，每次 5 天，保证使用人员能够正确操作设备的各项功能。并承诺 3-4 人省内及省外学习。

2. 质保期内伴随服务：

1、实施或监督所供货物的现场组装或试运行；

2、提供货物组装或维修所需的工具；

3、为所供货物的设备提供详细的操作和维护手册；

4、在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理；

5、在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护或修理对采购方人员进行培训。

3. 质保期外

我公司承诺在本项目质保期外还将继续为采购方提供以下伴随服务：

1、采购的整个设备系统提供终生维护；

2、根据采购方发展的需要，及时免费地提供系统扩充、完善规划和设计技术支持和指导；

3、对采购方购买新的硬件和本系统连接及升级时，免费提供安装和配合服务。

4、备品备件服务：提供备件库，存入所有必须得备件，提供所有设备五年正常使用所需的备品备件。

5、在备件停止生产的情况下，承诺将事先将要停止生产的计划通知采购方，以便采购方有足够的时间采购所需的备件；

6、在备件停止生产后，如果采购方要求，承诺将免费向采购方提供备件的蓝图、图纸和规格。

4. 付款方式承诺：遵守和履行甲方的付款要求

5. 其他优惠承诺；无

供应商名称（盖章）：甘肃药业集团三元医药有限公司

法定代表人或委托代理人：（签字）

日期：2024年12月27日

文明施工与环境保护管理举措

我公司承诺在本项目施工期间：

承诺 1、文明施工：由项目经理组织实行工地环境卫生制度及文明施工制度，公司负责监察检查，负责道路通畅、资料堆放及环境卫生等。保证施工污水不外流，场建筑垃圾集中堆放并实时清运；建筑垃圾实时清运，尽量降低施工产生的噪声。设置通告牌。运载建筑资料的车辆，用水冲刷净后驶离现场。成立员工技术操作经历资料和人事档案管理制度，按期分班组对员工进行有关技术操作的考核。

承诺 2、环境保护：我们将依照环境管理系统标准，成立环境管理系统，恪守纪规，预防污染，节能减废，力求达到施工与环境和睦，创立环境保护工作先进现场。

承诺 3、防护施工噪声污染：

除特别状况外，在每天晚 22 时至第二天早 6 时，严格控制机器噪声作业。模板、脚手架在支设、拆掉和搬运时，一定轻拿轻放，上下、左右有人传达。增强环保意识的宣传。


采纳有力举措控制人为的施工噪声，严格管理，最大限度地减少噪声扰民。荒弃物管理：荒弃物管理尤其重要。施工现场建立特意的荒弃物暂时储存场所，荒弃物应分类寄存，对有可能造成二次污染的荒弃物一定独自储存，设置安全防举措且有醒目标记。

4、工期保证举措：

为保证按招标工期按期完工及交托，我公司充足发挥机械、设护和管理力量的优势，采纳先进科学的管理方法，增强各专业施工班组

间的交错配合，进而加快施工进度，缩短工期。

供应商名称（盖章）： 甘肃药业集团三元医药有限公司

法定代表人或委托代理人： （签字）

日期：2024 年 12 月 27 日

附件四：原厂五年质保承诺书

PHILIPS

质保承诺函

致：上海市第一人民医院酒泉医院(酒泉市人民医院)

本单位就本次项目编号：JQZFCG-2024-1152号，上海市第一人民医院酒泉医院(酒泉市人民医院)医疗设备更新项目(二标段)(一包)、产品名称：数字减影血管造影床(悬吊式)(医用血管造影X射线系统) 型号：Azurion 5 M20，1套，在此郑重承诺：

为本次所供数字减影血管造影床(悬吊式)提供原厂全保5年(含球管、平板探测器)，售后响应时间7×24小时。

特此承诺！

飞利浦医疗(苏州)有限公司




附件五：中标通知书

中标通知书
(政府采购、公开)

项目编号：JQZFCG-2024-1152 号

中标供应商：甘肃药业集团三元医药有限公司

贵单位于 2024 年 12 月 24 日所递交的上海市第一人民医院酒泉医院（酒泉市人民医院）医疗设备更新项目（二标段）（一包）的投标文件，经评标委员会评定，确定贵单位中标，请务必于该项目中标公告公示期截止后 10 日内与我方签订合同。具体中标内容如下：

项目名称	上海市第一人民医院酒泉医院（酒泉市人民医院）医疗设备更新项目（二标段）（一包）		
中标价	大写：陆佰玖拾捌万元整 小写：¥6980000.00 元		
项目业主单位 (盖章) 负责人：  2024 年 12 月 26 日	代理机构 (盖章) 负责人：  2024 年 12 月 26 日	行业监管部门 (盖章) 负责人：  2024 年 12 月 26 日	酒泉市公共资源交易中心（盖章）  2024 年 12 月 26 日

- 1. 本中标通知书壹式伍份，项目业主单位、中标单位、招标代理机构、行业监管部门、酒泉市公共资源交易中心各壹份。
- 2. 此件涂改无效。
- 3. 请据此办理有关手续。