

兰州大学第二医院(第二临床医学院) 内窥镜项目

货物名称：电子上消化道内窥镜(放大)1套、电子结肠内窥镜(放大)1套、电子上消化道内窥镜(普通高清)1套、电子结肠内窥镜(普通高清)1套

合同备案号:2025HTBA00680

招标编号: 2024zfcgjk00088

合同编号: _____(HT)

买 方：兰州大学第二医院（第二临床医学院）

卖 方：甘肃海网视讯信息技术有限公司

招标代理：北京泛华国金工程咨询有限公司

合 同

合同号: _____/HT

签订日期: _____

签订地点: _____ 甘肃·兰州

兰州大学第二医院(第二临床医学院)(买方)和 甘肃海网视讯信息技术有限公司(卖方) 同意按下述条款和条件签署本合同。

1. 下列文件是构成本合同不可分割的部分

1.1 合同条款前附表;

1.2 合同条款;

1.3 合同条款附件:

附件 1-开标一览表;

附件 2-分项报价表;

附件 3-货物详细供货范围表;

附件 4-备品备件清单;

附件 5-专用工具清单;

附件 6-配置清单;

附件 7-技术规格偏离表;

附件 8-商务规格偏离表;

附件 9-中小企业声明函;

附件 10-售后服务承诺及相关内容;

附件 11-中标通知书;

1.4 招标文件

1.5 投标文件

2. 合同标的

2.1 买方同意购买, 卖方同意出售下表中的所有设备:

序号	货物名称	生产厂商	型号	数量	总价 (万元)
1	电子上消化道内窥镜(放大)1套、 电子结肠内窥镜(放大)1套、 电子上消化道内窥镜(普通高清)1套、 电子结肠内窥镜(普通高清)1套	详见开标一览表			183.6

总价（人民币大写）	壹佰捌拾叁万陆仟元
-----------	-----------

3. 合同金额

根据上述文件要求，合同的含税总价为 183.6 万元人民币，（大写：壹佰捌拾叁万陆仟元），分项价格在“分项报价表”中有明确规定。

4. 付款条件

4.1 货物到达交货地点，经买方（使用单位）安装、调试、试运行、培训，验收合格后，凭验收合格证明及按合同总价开具的发票（完税价），由买方支付合同总价款的 90%，剩余的 10% 作为质量保证金。

4.2 10% 质量保证金，待设备正常运行 叁 年（36 个月）无任何质量问题后，卖方提供质量保证金收据，买方支付 10% 合同货款。

5. 交货时间和交货地点

5.1 交货时间：合同签订 90 日历天安装调试完成

5.2 交货地点：兰州大学第二医院（第二临床医学院）

一、合同条款前附表

本表关于招标货物和服务的具体要求是对本合同通用条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本条款为准。

条款号	内 容
1.1 (5)	买方(使用单位)名称： 兰州大学第二医院（第二临床医学院） 买方(使用单位)地址： 甘肃省兰州市城关区萃英门 82 号
1.1 (6)	卖方（中标人）名称： 甘肃海网视讯信息技术有限公司 卖方（中标人）地址： 甘肃省兰州市城关区南昌路 6 号东湖广场财智中心写字楼 8 层 809 室
1.1 (7)	项目现场： 兰州大学第二医院（第二临床医学院）
10.3	1、货物到达交货地点，经买方（使用单位）安装、调试、试运行、培训，验收合格后，凭验收合格证明及按合同总价开具的发票（完税价），由买方支付合同总价款的 90%，剩余的 10%作为质量保证金。 2、10%质量保证金，待设备正常运行 <u>叁</u> 年（ <u>36</u> 个月）无任何质量问题后，卖方提供质量保证金收据，买方支付 10%合同货款。
12.1	1、质保期： <u>叁</u> 年。 2、维修响应：2 小时内响应，提供售后服务电话监督。能及时提供备用设备，不影响临床正常工作。 3、技术服务和培训：设备安装后，厂家提供专业人员对操作人员和护理人员进行培训，直到熟练掌握操作为止。 4、维修：驻地以上城市具有厂家备件库及售后服务工程师，支持安装、调试及维修。 其它详见招标文件第三章技术要求
15.1(3)	如主要设备的关键技术性能指标达不到招标文件中规定的指标要求，采购人除部分或全部扣除卖方质量保证金外，还将保留继续向中标人进一步索赔有关直接和间接经济损失的权力。

二、合同条款

1、定义

1.1 本合同下列词语应解释为：

(1) “合同”系指买方和卖方（以下简称合同双方）已达成的协议，即由双方签订的合同格式中的文件，包括所有的附件、附录和组成合同部分的所有参考文件。

(2) “合同价格”系指根据合同规定，在卖方全面正确地履行合同义务时应支付给卖方的价格。

(3) “货物”系指卖方按合同要求，须向买方提供的一切设备、机械、仪器、备件、工具、手册及其它技术资料和其它材料。

(4) “服务”系指合同规定卖方需承担的运输、保险、安装、试验、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

(5) “买方”系指买货物的单位。

(6) “卖方”系指提供合同货物和服务的制造商或投标人。

(7) “项目现场”系指将要进行货物安装的地点。

(8) “天”指日历天数。

2、原产地

原产地系指货物的开采、生产地，或提供辅助服务的来源地。

3、技术规格和标准

本合同项下所供货物的技术规格应与招标文件技术总则及技术规格中规定的标准相一致。若技术总则及技术规格中无相应规定，货物则应符合其原产地有关部门最新颁布的相应的正式标准。

4、专利权

卖方须保障买方在使用该货物、服务及其任何部分不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律和费用责任。

5、包装要求

5.1 提供的全部货物须采用相应标准的保护措施进行包装。这类包装应适于长途运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。卖方应承担由于其包装不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的责任。

5.2 每件包装箱内应附有一份详细装箱单和质量证书。

6、包装标记

6.1 卖方应在每一包装箱邻接的四个侧面用不易褪色的油漆以醒目的中文印刷字样标明以下各项：

- (1) 项目名称：
- (2) 合同号：
- (3) 收货人：
- (4) 到站：
- (5) 货物的名称、包号、箱号：
- (6) 毛重/净重（公斤）：
- (7) 尺寸（长×宽×高，以厘米计）：
- (8) 发货单位：

凡重达两吨或两吨以上的包装，卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，并根据货物的特点和运输的不同要求，以清晰字样在包装箱上注明“小心轻放”、“勿倒置”、“防潮”等适当的标志，以便装卸和搬运。

6.2 标识设备配置信息卡片。

7、装运条件

7.1 卖方应在合同规定的交货期前 30 个日历日以传真或邮件通知买方合同号、货物名称、数量、包装件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥待运日期。同时，卖方应以挂号信寄给买方详细交货清单一式三份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积（立方米）和每一包装箱的尺寸（长×宽×高）、

单价和总价、备妥待运日期，以及货物在运输和仓储中的特殊要求和注意事项。

7.2 卖方负责安排到站前内陆运输。

7.3 货物到达现场后，由卖方负责清点、检验合格并办理相关手续后日期应视为是货物的交货期。

7.4 卖方装运的货物不准超过合同规定的数量或重量，否则，一切后果均由卖方承担。

8、装运通知

8.1 卖方应在货物装货后发运前 24 小时内以传真或邮件通知买方合同号、货物名称、数量、毛重、体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及启运日期。如果包装件重量超过 20 吨或尺寸达到或超过 12 米长、2.7 米宽和 3 米高，卖方应将其重量或尺寸通知买方。若货物中有易燃品或危险品，卖方也须将详细情况通知买方。

9、保险

9.1 按合同提供的设备、工器具等，从卖方至合同目的地的运输保险，由卖方负责投保并承担全额保险费。保险应以人民币按照发票金额的 110% 办理“一切险”。

10、付款

10.1 本合同以人民币付款。

10.2 卖方应按照双方签订的合同规定交货。交货后买方按合同规定审核后付款：

10.3 买方将按合同条款前附表规定的付款条件安排付款，并提供国家税务发票。

11、伴随服务

11.1 卖方还应提供以下服务：

- (1) 负责设备现场集成安装、调试、交接试验和试运行；
- (2) 承担在质量保证期内的所有义务；

(3) 负责对买方人员进行技术培训。

11.2 伴随服务的费用应含在合同价中，不单独支付。

11.3 卖方应提交与设备相符的中文（或双方同意的其它语言）技术资料，并于合同生效后 15 天内寄送到买方，包括但不限于：样本、图纸、操作手册、使用说明、维修指南或服务手册等。如本条款所述资料寄送不完整或丢失，卖方应在收到买方通知后 30 天内免费另寄。

11.4 一套完整的上述资料应包装好随每批货物发运。

12、质量保证期

12.1 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的和用一流工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。卖方应保证其设备在正确安装、正常运转和保养条件下，在其使用期内应具有满意的性能。在质量保证期内卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，其费用由卖方承担。

12.2 根据有关部门的检验结果，在项目实施过程中直至质量保证期内，如果设备的数量、质量、规格与合同不符，或证实设备是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用了不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式向卖方提出本保证下的索赔。

12.3 卖方在收到通知后十四天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

12.4 如果卖方在收到通知后十四天内没有弥补缺陷。买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担。买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

13、检验

13.1 买方根据需要派员参加中间监制和出厂验收或派代表参加交货地点验收。

13.2 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是

付款时所需要的文件的组成部分，但不能作为有关质量、规格、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在检验证书后面。

13.3 如果在项目实施过程中直至质量保证期内，经过商检局或质量技术监督部门检验，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方应根据第 15 条规定立即向卖方提出索赔。

14、服务

14.1 在卖方的设备到达现场后，由卖方负责清点、保管，费用由卖方承担。买方可提供存放地点。

14.2 根据工程的进度情况，卖方应及时派技术人员到现场负责安装、试车及调试等工作。

15、索赔

15.1 如果卖方对货物与合同要求不符负有责任，并且买方已于规定的质量保证期内和检验、安装、调试和验收测试期限内提出索赔，卖方应按买方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

(1) 卖方同意买方拒收货物并把被拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给买方，卖方负担发生的一切损失和费用，包括利息、银行费用、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

(2) 根据货物的低劣和受损程度以及买方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

(3) 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的规格、质量和性能，卖方承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长更换货物的质量保证期。

15.2 如果买方提出索赔通知后 10 个日历日内卖方未能予以答复，该索赔应视为已被卖方接受。若卖方未能在买方提出索赔通知的 10 天内或买方同意延长时间内，按买方同意的上述任何一种方式处理索赔事宜，买方将从合同金额中扣回索赔金额。

16、延期交货

16.1 卖方应按照合同中买方规定的时间交货和提供服务。

16.2 除卖方因不可抗力外而拖延交货将受到以下制裁：按 18.1 条加收误期赔偿。

17、延期付款

买方应按照合同条款前附表中的付款条件，按时付款。

18、误期赔偿

除合同第 19 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其它补救方法，赔偿费按合同总价款每天 0.1% 计收。但违约损失赔偿的最高限额为迟交设备或未提供服务的合同价的 30%。如果达到最高限额，买方有权终止合同。

19、不可抗力

19.1 签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，则延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的。

19.2 受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报或电传通知对方，并于事故发生后 14 天内将有关当局出具的证明文件用挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事故的影响持续 120 天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

20、税费

卖方应承担根据现行税法向卖方课征的与履行本合同有关的一切税费。

21、履约保证金（无）

22、争端的解决

22.1 在执行本合同中发生的或与本合同有关的争端，双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，双方均可向买方所在地人民法院提起诉讼。

22.2 在诉讼期间，除正在进行诉讼部分外，合同其它部分继续执行。

23、违约终止合同

23.1 出现下列情况之一的，买方可向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

(1) 如果卖方未能在合同规定的限期内或买方同意延长的限期内完成并交付货物；

(2) 如果卖方未能履行合同规定的其它相关义务；

(3) 如果买方认为卖方在本合同的竞争或实施中有不正当行为。

23.2 如果买方根据上述第 23.1 条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交设备类似的设备，卖方应承担买方购买类似设备所超出的部分费用。但是卖方应继续执行合同中未终止的部分。

24、转让与分包

除买方书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同项下的义务。

25、通知

本合同任何一方给另一方的通知都应以书面的形式发送，该通知发送到本合同所确认的通讯地址即视为送达。

26、合同生效及其它

本合同经买、卖双方授权代表签字并加盖公章，并在买方收到卖方提交的履约保证金后生效。

26.2 如需修改合同内容，双方应签署书面修改或补充协议，该修改协议作为本合同的一个组成部分。

26.3 本合同一式 陆 份，其中，买方 贰 份，卖方 贰 份，鉴证方 贰 份。

附件 1-开标一览表（与投标文件保持一致）

开标一览表

投标人名称：甘肃海网视讯信息技术有限公司

项目名称：兰州大学第二医院（第二临床医学院）内窥镜项目 招标文件编号：2024zfcg.jk00088

包号：01

序号	投标人名称	总价 (万元)	设备名称	品牌	规格/型号	国别
1	甘肃海网视讯信息技术有限公司	183.6	内窥镜	奥林巴斯	GIF-H290Z、CF-HQ290ZI、GIF-H290、CF-H290I	日本

投标人（公章）：甘肃海网视讯信息技术有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：永成

日期：2025 年 3 月 24 日

注：

- 1. 报价应是设备主机及附件货款、运输费、运输保险费、装卸费、安装调试费及其他应有的费用。投标人所报价格为货到现场安装调试完成的最 终优惠价格。
- 2. “开标一览表” 必须签字或盖章，否则为无效投标，可以逐页签字或盖章也可以在落款处签字或盖章。
- 3. “开标一览表” 按包分别填写。

附件 2-分项报价表（与投标文件保持一致）

分项报价表

投标人名称：甘肃海网视讯信息技术有限公司

项目名称：兰州大学第二医院（第二临床医学院）内窥镜项目

招标文件编号：2024zfcg.jk00088

包号：01

单位：万元

序号	设备名称	品牌	规格/型号	生产厂家/产地	数量	单位	单价（元）	总价（元）	交货期	备注
1	电子上消化道内窥镜(放大)	奥林巴斯	GIF-H290Z	奥林巴斯医疗株式会社	1	根	500000	500000	60 日历天	无
2	电子结肠内窥镜（放大）	奥林巴斯	CF-HQ290ZI	奥林巴斯医疗株式会社	1	根	580000	580000	60 日历天	无
3	电子上消化道内窥镜(普通高清)	奥林巴斯	GIF-H290	奥林巴斯医疗株式会社	1	根	344000	344000	60 日历天	无
4	电子结肠内窥镜(普通高清)	奥林巴斯	CF-H290I	奥林巴斯医疗株式会社	1	根	412000	412000	60 日历天	无

投标人（公章）：甘肃海网视讯信息技术有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：李保华

日期：2025年3月24日

注：

1. 报价明细表中应列明开标一览表中每个分项内容。
2. 如国产品，产地精确到省级行政区域；如进口产品，产地精确到国家。

附件 3-货物详细供货范围表（与投标文件保持一致）

货物详细供货范围表

序号	货物名称	规格型号	商标	单重	总重	单位	数量	单价	总价	制造厂	备注
1	电子上消化道内窥镜(放大)	GIF-H290Z	OLYMPUS	/	/	根	1	500000	500000	奥林巴斯医疗株式会社	
2	电子结肠内窥镜(放大)	CF-HQ290ZI	OLYMPUS	/	/	根	1	580000	580000	奥林巴斯医疗株式会社	
3	电子上消化道内窥镜(普通高清)	GIF-H290	OLYMPUS	/	/	根	1	344000	344000	奥林巴斯医疗株式会社	
4	电子结肠内窥镜(普通高清)	CF-H290I	OLYMPUS	/	/	根	1	412000	412000	奥林巴斯医疗株式会社	

注：1、要求对所投货物按部件、元器件进行明细报价，并必须标明制造厂家名称。

投标人（签字、盖章）：甘肃海网视讯信息技术有限公司



日期：2025 年 3 月 24 日

附件 4-备品备件清单（与投标文件保持一致）

备品备件清单（随机备品备件）

序号	设备名称	规格型号	图号	材质	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	制造厂	备注
1	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

投标人（签字、盖章）：甘肃海网视听信息技术有限公司



日期：2025 年 3 月 24 日

备品备件清单（设备连续、正常生产二年期间所需的）

序号	设备名称	规格型号	图号	材质	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	制造厂	备注
1	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

注：此表备品备件报价不包含在投标总价中。

投标人（签字、盖章）：甘肃海网视讯信息技术有限公司



日期：2025 年 3 月 24 日

附件 5-专用工具清单（与投标文件保持一致）

专用工具清单

序号	设备名称	规格型号	图号	材质	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	制造厂	备注
1	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

投标人（签字、盖章）： 甘肃海网视听信息技术有限公司

日期：2025 年 3 月 24 日

附件 6-配置清单（与投标文件保持一致）

配置清单

序号	品目	数量（带单位）注	备注
1	电子十二指肠内窥镜(放大)	1 根	
2	电子结肠内窥镜（放大）	1 根	
3	电子十二指肠内窥镜(普通高清)	1 根	
4	电子结肠内窥镜(普通高清)	1 根	



投标产品详细配置

项目名称：兰州大学第二医院（第二临床医学院）内窥镜项目

招标文件编号：2024zfcgjk00088

包 号：01

序号	货物名称	规格型号	详细配置及技术标准
1	电子胃镜(普通高清)		HDTV 高清晰成像方式，一触式接头全防水设计； NBI 窄波光观察功能； 视野方向：直视； 视野角：140 度； 景 深：近 焦 3-7mm 常 规 焦 距 7-100mm； 先端部外径：10.2mm； 弯曲角度上 210°，下 90°，左 100° 右 100° ； 管道内径：2.8mm； 有效长度：1030mm，全长 1350mm； 有副送水功能；
2	电子结肠内窥镜（普通高清）		NBI 窄波光观察功能； 常规视野角度 170° 近焦角度 160° ； 景深：具有双焦点、近焦 4-9mm;常规焦距 9-100mm； 管道内径：3.7mm； 先端部外径:13.2mm； 弯曲角度上 180°，下 180°，左 160° 右 160° ； 全长 1650mm，有效长度 1330mm； 有三路导光束； 有可变硬度调节功能； HFT 强力传导功能； PB 智能弯曲功能； 有副送水功能； 可通过 ScopeGuide 导航设备实现肠镜形态显示功能；
3	电子胃镜		HDTV 高清晰度成像方式；

4	道内窥镜(放大)	NBI 窄波光观察模式; 视野方向 0 度直视; 视野角: 常规 140°, 近焦 95°; 景深: 常规 7-100mm, 放大:1.5-3mm; 照明方式: 光导方式; 先端部外径: 9.9mm; 弯曲角度:210°, 下 90°, 左 100°, 右 100°; 管道内径: 2.8mm; 有效长度: 1030mm, 全长 1350mm; 有 3 路导光束; 有副送水功能; 镜子先端具有圆弧设计; 内镜按钮数 4; 内镜按钮控制: 冻结图像、放大图像、打印、录像、照相等; 激光兼容性 & 高频兼容性; 一触式防水接头设计, 无需防水帽, 简化安装, 直接浸泡消毒, 减少意外浸水。
	电子结肠内窥镜(放大)	HDTV 高清成像方式的 CCD; NBI 窄波光观察模式; 视野角 常规焦距 170° 近焦 90°; 景深: 近焦 2-3mm, 常规 7-100mm; 照明方式: 光导方式; 插入部外径: 12.8mm; 先端部外径: 13.2mm; 弯曲角度: 上/下 180°, 左/右 160°; 管道内径: 3.7mm; 有效长度: 1330mm, 全长 1655mm; 有 3 路导光束; 有 3 档可变硬度功能; HFT 智能弯曲功能; PB 有强力传导功能; 内镜遥控按钮数 5; 内镜按钮控制: 冻结图像、放大图像、打印、录像、照相等;

			激光兼容性 & 高频兼容性；
			一触式防水接头设计，无需防水帽， 简化安装，减少意外浸水。

注：

可采用表格或文字描述，格式由投标人自定。

投标人（公章）：甘肃海网视讯信息技术有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：齐永华

日 期： 2025 年 3 月 24 日



附件 7-商务规格偏离表（与投标文件保持一致）

商务响应表

项目名称：兰州大学第二医院（第二临床医学院）内窥镜项目

招标文件编号：2024zfcgjk00088

包 号：01

序号	采购要求	应答	偏离说明	备注
(一) 报价要求				
1	固定总价（本项目投标报价应包括完成招标文件规定的招标范围全部内容所需的全部费用除非招标文件另有规定，投标报价应包括完成本项目所需设备成本、人力成本、运输、安装、调试、管理费、保险、利润、税金、劳保统筹、政策性文件规定及合同包含的所有风险、优惠率、责任、备品备件等各项应有费用。投标报价采用唯一价格，即不得为某一范围价格；报价货币为人民币。供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报价部分的费用已包括在已报价的分项报价中而不予支付）。	固定总价（本项目投标报价应包括完成招标文件规定的招标范围全部内容所需的全部费用除非招标文件另有规定，投标报价应包括完成本项目所需设备成本、人力成本、运输、安装、调试、管理费、保险、利润、税金、劳保统筹、政策性文件规定及合同包含的所有风险、优惠率、责任、备品备件等各项应有费用。投标报价采用唯一价格，即不得为某一范围价格；报价货币为人民币。供应商漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报价部分的费用已包括在已报价的分项报价中而不予支付）。	无偏离	
(二) 服务要求				
1	其他要求：所采购设备需要含三年保修。	其他要求：所采购设备需要含三年保修。	无偏离	
2	质保期：3 年（自验收合格之日起计算）。	质保期：3 年（自验收合格之日起计算）。	无偏离	
3	故障响应要求：全年 7×24 小时电话响应，48 小时内专业技术人员赶赴现场进行维修。如需更换部件，7 个工作日内完成故障维修工作。	故障响应要求：全年 7×24 小时电话响应，48 小时内专业技术人员赶赴现场进行维修。如需更换部件，7 个工作日内完成故障维修工作。	无偏离	
4	售后服务：每年不少于 4 次，有故障必须马上提供备品及时维修。	售后服务：每年不少于 4 次，有故障必须马上提供备品及时维修。	无偏离	

5	培训要求：中标供应商根据用户需求，组织进行集中培训或在用户使用现场进行产品技术和使用培训，培训次数每年不少于2次，培训人员包括医生和护士。	培训要求：中标供应商根据用户需求，组织进行集中培训或在用户使用现场进行产品技术和使用培训，培训次数每年不少于2次，培训人员包括医生和护士。	无偏离	
6	安装调试服务要求：设备由生产厂家人员在用户指定地点提供安装、调试等服务。	安装调试服务要求：设备由生产厂家人员在用户指定地点提供安装、调试等服务。	无偏离	
(三) 交货要求				
1	交货时间：自合同签订后 60 日历天。	交货时间：自合同签订后 60 日历天。	无偏离	
2	交货地点：兰州大学第二医院（第二临床医学院）指定地点。	交货地点：兰州大学第二医院（第二临床医学院）指定地点。	无偏离	
(四) 付款方式				
1	付款方式：验收合格后付款 90%，剩余 10%作为质保金，待设备正常运行 3 年（以文件质保期为准）无任何质量问题后付清剩余款项。	付款方式：验收合格后付款 90%，剩余 10%作为质保金，待设备正常运行 3 年（以文件质保期为准）无任何质量问题后付清剩余款项。	无偏离	
(五) 履约保证金				
	无	无	无偏离	
(六) 验收方法及标准				
1	验收要求：货物送达采购人指定位置后由采购人明确的专人负责对货物品种、数量、规格等进行点验、接收；若现场检验的时候发现设备有缺货、有缺陷、损坏、生锈或有瑕疵等情况，采购人有权拒绝接收货物同时要求更换全新的货物。若采购人同意接收中标人货物时（若存在不影响实质性使用的情况下），中标人应采取必要的措施，如补充、修理或替换等，使设备处于完好状况，由此而产生的费用由中标人承担。	验收要求：货物送达采购人指定位置后由采购人明确的专人负责对货物品种、数量、规格等进行点验、接收；若现场检验的时候发现设备有缺货、有缺陷、损坏、生锈或有瑕疵等情况，采购人有权拒绝接收货物同时要求更换全新的货物。若采购人同意接收中标人货物时（若存在不影响实质性使用的情况下），中标人应采取必要的措施，如补充、修理或替换等，使设备处于完好状况，由此而产生的费用由中标人承担。	无偏离	

注：

1. 不提供此表视为无效响应。
2. 不如实填写偏离情况的视为虚假材料。
3. 条款号指项目需求书中的序号或者编号，项目需求书中标注“●”的条款，也必须在“条款号”中标注“●”。
4. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处，如：正偏离、负偏离、无偏离。
5. 投标人在《商务响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人（公章）：甘肃海网视讯信息技术有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 2025 年 3 月 24 日

附件 8-技术规格偏离表（与投标文件保持一致）

技术响应表

项目名称：兰州大学第二医院（第二临床医学院）内窥镜项目

招标文件编号：2024zfcgjk00088

包 号：01

项目需求书所有条款的应答			
条款号	招标要求	投标应答	偏离说明
1、电子上消化道内窥镜(普通高清)	(1) 具有高清晰成像方式，一触式接头全防水设计；	HDTV 高清晰成像方式，一触式接头全防水设计；	无偏离
	(2) 具有窄波光观察功能；	NBI 窄波光观察功能；	无偏离
	(3) 视野方向：直视；	视野方向：直视；	无偏离
	(4) 视野角：≥140 度；	视野角：140 度；	无偏离
	* (5) 景深：近焦 3-7mm 常规焦距 7-100mm；	景深：近焦 3-7mm 常规焦距 7-100mm；	无偏离
	(6) 先端部外径：≤10.2mm；	先端部外径：10.2mm；	无偏离
	(7) 弯曲角度上≥210°，下≥90°，左≥100° 右≥100°；	弯曲角度上 210°，下 90°，左 100° 右 100°；	无偏离
	(8) 管道内径：≥2.8mm；	管道内径：2.8mm；	无偏离
	(9) 有效长度：≥1030mm，全长≥1350mm；	有效长度：1030mm，全长 1350mm；	无偏离
	* (10) 具有副送水功能；	有副送水功能；	无偏离
2、电子结肠内窥镜（普通高清）	(1) 能够实现窄波光观察功能；	NBI 窄波光观察功能；	无偏离
	* (2) 常规视野角度≥170° 近焦角度≥160°；	常规视野角度 170° 近焦角度 160°；	无偏离
	* (3) 景深：具有双焦点、近焦 4-9mm 常规焦距 9-100mm；	景深：具有双焦点、近焦 4-9mm:常规焦距 9-100mm；	无偏离
	(4) 管道内径：≥3.65mm；	管道内径：3.7mm；	无偏离
	(5) 先端部外径≤13.2mm；	先端部外径:13.2mm；	无偏离
	(6) 弯曲角度上≥180°，下≥180°，左≥160° 右≥160°；	弯曲角度上 180°，下 180°，左 160° 右 160°；	无偏离
	(7) 全长≥1650mm，有	全长 1650mm，有效长度	无偏离

	效长度 $\geq 1330\text{mm}$;	1330mm;	
	(8) 具有三路导光束;	有三路导光束;	无偏离
	(9) 具有可变硬度调节功能;	有可变硬度调节功能;	无偏离
	(10) 具有强力传导功能;	HFT 强力传导功能;	无偏离
	(11) 具有智能弯曲功能;	PB 智能弯曲功能;	无偏离
	(12) 具有副送水功能;	有副送水功能;	无偏离
	* (13) 可通过导航设备实现肠镜形态显示功能;	可通过 ScopeGuide 导航设备实现肠镜形态显示功能;	无偏离
3、电子上消化道内窥镜(放大)	(1) 具有高清晰度成像方式;	HDTV 高清晰度成像方式;	无偏离
	(2) 具有窄波光观察模式;	NBI 窄波光观察模式;	无偏离
	(3) 视野方向 0 度直视;	视野方向 0 度直视;	无偏离
	* (4) 视野角: 常规 $\geq 140^\circ$, 近焦 $\geq 75^\circ$;	视野角: 常规 140° , 近焦 95° ;	正偏离
	(5) 景深: 常规 7-100mm, 放大: 1.5-3mm;	景深: 常规 7-100mm, 放大: 1.5-3mm;	无偏离
	(6) 照明方式: 光导方式;	照明方式: 光导方式;	无偏离
	(7) 先端部外径: $\leq 9.9\text{mm}$;	先端部外径: 9.9mm;	无偏离
	(8) 弯曲角度: $\geq 210^\circ$, 下 $\geq 90^\circ$, 左 $\geq 100^\circ$, 右 $\geq 100^\circ$;	弯曲角度: 210° , 下 90° , 左 100° , 右 100° ;	无偏离
	(9) 管道内径: $\geq 2.8\text{mm}$;	管道内径: 2.8mm;	无偏离
	(10) 有效长度: $\geq 1030\text{mm}$, 全长 $\geq 1350\text{mm}$;	有效长度: 1030mm, 全长 1350mm;	无偏离
	* (11) 具有 ≥ 3 路导光束;	有 3 路导光束;	无偏离
	(12) 具有副送水功能;	有副送水功能;	无偏离
	(13) 镜子先端具有圆弧设计;	镜子先端具有圆弧设计;	无偏离
	(14) 内镜按钮数 ≥ 4 ;	内镜按钮数 4;	无偏离
	(15) 内镜按钮控制: 冻结图像、放大图像、打印、录像、照相等;	内镜按钮控制: 冻结图像、放大图像、打印、录像、照相等;	无偏离
	(16) 具有激光兼容性及高频兼容性;	激光兼容性及高频兼容性;	无偏离
	* (17) 具有一触式防水接头设计, 无需防水帽, 简化安装, 直接浸泡消毒;	一触式防水接头设计, 无需防水帽, 简化安装, 直接浸泡消毒, 减少意	无偏离

	减少意外浸水。	外浸水。	
4. 电子结肠内窥镜（放大）	(1) 具有 HDTV 成像方式的 CCD;	HDTV 高清成像方式的 CCD;	无偏离
	(2) 具有窄波光观察模式;	NBI 窄波光观察模式;	无偏离
	* (3) 视野角 常规焦距 $\geq 170^\circ$ 近焦 $\geq 90^\circ$;	视野角 常规焦距 170° 近焦 90° ;	无偏离
	(4) 景深: 近焦 2-3mm 常规 7-100mm;	景深: 近焦 2-3mm 常规 7-100mm;	无偏离
	(5) 照明方式: 光导方式;	照明方式: 光导方式;	无偏离
	(6) 插入部外径: $\leq 12.8\text{mm}$;	插入部外径: 12.8mm;	无偏离
	(7) 先端部外径: $\leq 13.2\text{mm}$;	先端部外径: 13.2mm;	无偏离
	(8) 弯曲角度: 上/下 $\geq 180^\circ$, 左/右 $\geq 160^\circ$;	弯曲角度: 上/下 180° , 左/右 160° ;	无偏离
	(9) 管道内径: $\geq 3.7\text{mm}$;	管道内径: 3.7mm;	无偏离
	(10) 有效长度: $\geq 1330\text{mm}$, 全长 $\geq 1655\text{mm}$;	有效长度: 1330mm, 全长 1655mm;	无偏离
	* (11) 具有 ≥ 3 路导光束;	有 3 路导光束;	无偏离
	(12) 具有 ≥ 3 档可变硬度功能;	有 3 档可变硬度功能;	无偏离
	(13) 具有智能弯曲功能;	HFT 智能弯曲功能;	无偏离
	(14) 具有强力传导功能;	PB 有强力传导功能;	无偏离
	(15) 内镜遥控按钮数 ≥ 5 ;	内镜遥控按钮数 5;	无偏离
	(16) 内镜按钮控制: 冻结图像、放大图像、打印、录像、照相等;	内镜按钮控制: 冻结图像、放大图像、打印、录像、照相等;	无偏离
	(17) 具有激光兼容性及高频兼容性;	激光兼容性及高频兼容性;	无偏离
	(18) 具有一触式防水接头设计, 无需防水帽, 简化安装, 减少意外浸水。	一触式防水接头设计, 无需防水帽, 简化安装, 减少意外浸水。	无偏离

注:

1. 不如实填写偏离情况的电子投标文件将视为虚假材料。

2. 条款号指项目需求书中的序号或者编号, 项目需求书中标注“●”的条款, 也必须在“条款号”中标注“●”。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处, 如: 正偏离、负偏离、无偏离。

4. 投标人在《技术响应表》的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述, 将被视为不符

合招标文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

5.技术响应表的投标应答内容应提供技术支撑材料。

投标人（公章）：甘肃海网视讯信息技术有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 张景华

日期：2025 年 3 月 24

附件 9-中小企业声明函：（与投标文件保持一致）

声明函

致：兰州大学第二医院（第二临床医学院）

我们在此郑重声明，根据相关政策及规定，我司（公司名称：甘肃海网视讯信息技术有限公司）参与的兰州大学第二医院（第二临床医学院）内窥镜项目的投标产品的制造商（奥林巴斯医疗株式会社）不属于中小微企业、监狱企业或残疾人企业，特此声明。

感谢贵方对我司的关注与支持！

公司名称：甘肃海网视讯信息技术有限公司

日期：2025年3月24日



制造厂商资格声明

(1) 名称和其他资料:

- a) 制造厂商/供货商名称: 奥林巴斯医疗株式会社
 b) 制造厂商/供货商注册地址: 日本国东京都八王子市石川町 2951 番地
 c) 制造厂商/供货商生产责任地址: 参考如下 (2) 工厂名称及地址和产品信息
 d) 制造厂商/供货商总公司名称: 奥林巴斯株式会社
 e) 总部地址: 日本国东京都新宿区西新宿 2-3-1 Monolith
 电传/传真/电话号码: +81-3-3340-2111
 f) 制造厂商总公司成立和/或注册时间: 1919 年 10 月 12 日
 法人代表姓名: 樱井友尚 (先生)
 g) 制造厂商/供货商在中国境内供货商名称、地址 (如有):
 奥林巴斯(北京)销售服务有限公司
 北京朝阳区新源南路 1-3 号 商业写字楼 8 座 803
 电传/传真/电话号码: TEL: 010-58199000 / FAX: 010-59761299

h) 总公司注册资本: 1246 亿/日元

下列为最新的资产负债和损益情况:

(i) 固定资产	: 40,618	百万/日元
(ii) 流动资产	: 45,443	百万/日元
(iii) 总资产	: 86,061	百万/日元
(iv) 长期负债	: 5	百万/日元
(v) 短期负债	: 61,714	百万/日元
(vi) 总负债	: 61,719	百万/日元

(2) 工厂名称及地址和产品信息:

工厂名称及地址	产品信息
会津奥林巴斯株式会社 福岛县会津若松市田町 大字饭寺字村西 500 番地	医用内窥镜和消毒装置, 内窥镜位置检测装置的探头
青森奥林巴斯株式会社 青森县奥石市追分 2-248-1	内窥镜治疗设备, 超声手术设备, 与内窥镜和超声成像系统配合使用的无菌光源器械, 以及与内窥镜位置检测仪器配合使用的灭菌内窥镜治疗设备
白河奥林巴斯株式会社 福岛县西白河郡西乡村小 田食字藏山 3-1	光源、图像处理装置、内窥镜位置检测仪器、电热烧灼仪器、集成内窥镜手术系统、内窥镜中调节/控制仪器、内窥镜摄像头/泵/监视器/记录器、电外科设备、气腹机、超声诊断成像系统、超声外科设备和内窥镜, 超声碎石机、腹腔镜内窥镜的探头和换能器
日之出工厂 东京都西多摩郡日之出町 平井 34-3	内窥镜, 内窥镜检查设备, 图像处理装置, 内窥镜调节/控制控件, 摄像头, 腹腔镜内窥镜系统, 超声诊断图像系统, 超声手术系统换能器, 硬组织超声手术系统支架/先端, 手术显微镜, 水容器, 供水管, 与内窥镜结合使用的无菌光源仪器的供水阀和脚踏开关, 与医用超声诊断图像系统结合使用的灭菌光源设备, 与医疗内窥镜系统配合使用的 IT 产品, 关节镜手术扩张器, 可重复使用的关节镜手术引导设备, 关节镜手术测距仪器, 非侵入性

奥林巴斯 越南工厂： 越南重乃查隆城工业园区 第8大道	商店网、医用内镜连接专用内镜设备及相关配件
-----------------------------------	-----------------------

(3) 过去三年产品销售的公司名称和地址

	年份	公司名称、地址	销售产品
在中国境内 销售	2021	奥林巴斯(北京)销售服务有限公司	2021年销售 2021年销售
	2022	奥林巴斯(北京)销售服务有限公司	2022年销售
	2023	奥林巴斯(北京)销售服务有限公司	2023年销售

(4) 类似产品及服务成功提供的至少2个项目的叙述:

哈尔滨医科大学附属第一医院 电子支气管镜镜
北京大学人民医院 纤维支气管镜镜

(5) 过去三年营业额:

年度	本国境内	本国境外	合计
2021 年	1016.89亿/日元	5237.07亿/日元	6254.86亿/日元
2022 年	1108.96亿/日元	6252.07亿/日元	7361.03亿/日元
2023 年	1166.42亿/日元	7533.98亿/日元	8700.39亿/日元
总计	3292.27亿/日元	18823.12亿/日元	22115.49亿/日元

(6) 开户行名称和地址:

银行名称: 日本三菱东京 (M) 银行 新宿中央支行
地址: 日本东京都新宿区西新宿1-1-1

(7) 制造商/供货商所属集团公司 (如有):

奥林巴斯株式会社

(8) 其他资料 (如发债大事记、组织架构图等)

无

我们在此保证贵国所述的资料 and 证明是真实和正确的。所有要求的资料和数据已经提供在此。我们同意贵方的要求提供任何所需要的其它资料。

贵野茂树 副总裁 奥林巴斯医疗株式会社

(打印授权代表姓名和职务)

奥林巴斯医疗株式会社

(制造商/供货商名称)

2024 年 1 月 35 日 (日期)

03-642-2111 (电话/传真/电报号码)

附件 10-售后服务承诺及相关内容（与投标文件保持一致）

（1）货物质量与售后服务、优惠条件及培训计划承诺书

致采购人名称：兰州大学第二医院（第二临床医学院）

关于贵方 2025 年 3 月 24 日就（兰州大学第二医院（第二临床医学院）内窥镜项目/2024zfcg1k00088）招标采购事宜，我公司作为供应商，作如下保证：

1. 供货周期：自合同签订后60日历天
2. 质量保证期：3年（自验收合格之日起计算）

3. 产品质量承诺：货物送达采购人指定位置后由采购人明确的专人负责对货物品种、数量、规格等进行点验、接收；若现场检验的时候发现设备有缺货、有缺陷、损坏、生锈或有瑕疵等情况，采购人有权拒绝接收货物同时要求更换全新的货物。若采购人同意接收中标人货物时（若存在不影响实质性使用的情况下），中标人应采取必要的措施，如补充、修理或替换等，使设备处于完好状况，由此而产生的费用由中标人承担。

4. 售后服务承诺：每年不少于4次，有故障马上提供备品及时维修。

5. 包退包换承诺：在质保期内，因设备本身质量问题导致的故障，本公司将提供免费维修服务（包括人工费和零部件更换费用）。

6. 应急维修时间安排：全年7×24小时电话响应，48小时内专业技术人员赶赴现场进行维修。如需更换部件，7个工作日内完成故障维修工作。

7. 维护保养的安排：每季度进行设备巡检，根据设备使用频率和厂家建议，制定定期维护计划，一般建议每季度进行一次巡检，每年进行一次全面保养，提供年度设备使用评估报告，在巡检过程中，若发现设备存在潜在问题，及时进行故障排查和修复，避免设备出现更大故障。

(2) 售后服务人员信息表

投标人应详细说明售后服务保证内容,出现故障响应时间及售后服务人员情况(特别是售后服务技术人员简历介绍),并填写下表:

厂商(电话、地址、联系人)
奥林巴斯医疗株式会社(400-820-2084、日本国东京都八王子市石川町2951番地)
现行售后服务的主要内容:(可附宣传材料)



售后服务承诺书

一、质量保证:我公司保证所提供的产品均满足国家规定的产品技术要求。

二、装机服务:

货到用户指定场所,我公司派工程师免费上门安装调试。

三、设备保修:对我司销售的奥林巴斯产品提供保修服务

1、保修范围:

奥林巴斯内镜主机产品(如内镜、图像处理中心、冷光源、高频电烧等)由于质量问题而引起的故障由奥林巴斯厂家进行免费维修,以下情况不属于保修范围:

- 1) 消耗品(如治疗附件、手术器械、灯泡等内镜配件)。
- 2) 经与奥林巴斯无关的维修中心修理过,或擅自改装拆卸过的设备。
- 3) 由于人为因素及使用不当引起的产品故障,例如喷嘴堵塞、弯曲橡皮针孔,因使用不合格或规格不匹配附件导致的活检管道破损、清洗消毒不当引起的内镜外皮脱落或腐蚀、插入管及弯曲管受压或刮破、内镜先端部受外力撞击导致摄像头组件或导光组件破损、清洗消毒时未盖防水帽或盖了ETO帽浸泡、光学视管受外力碰撞导致透镜结构松动等。
- 4) 由于运输不当或火灾、洪水等天灾引起的故障。
- 5) 未使用奥林巴斯产品清洗消毒灭菌手册中提及的已验证的清洗消毒机、消毒液、灭菌器进行清洗、消毒、灭菌引起的故障。

2、产品保修期:

除特殊保修期的产品以外,其他产品的产品保修期为 叁 年;特殊产品保修期的产品请参见附件。

保修期起算日:

- 1) 出库3个月内回收安装确认书:从装机日起算;
- 2) 出库3个月内未回收安装确认书:从出库日+7天起算

四、响应时间:

我方接到用户报修通知,如需现场对应响应时间为:

- 1、分公司所在城市到达现场时间:24小时内
- 2、分公司所在地以外城市到达现场时间:3个工作日内

五、其他服务:

- 1、在设备调试期间,公司免费提供使用和保养的中文手册,并对医生就设备的操作规范以及操作注意事项进行重点介绍和培训。
- 2、我公司售后服务人员定期巡回,并根据客户需要提供故障预防培训。

- 3、公司将不定期举办学术交流活动，提供技术支持及培训，并为客户提供各种形式的配件使用、维护保养、故障预防类资料，提高用户操作及诊断水平。
- 4、如与我司签订服务合同，并修理等级为大修理时，可享受备件优先出借权。

六、维修服务网络：

奥林巴斯（北京）销售服务有限公司在北京、上海、广州、沈阳设立服务中心，由奥林巴斯（北京）销售服务有限公司直接管理，对应维修业务，范围覆盖全国。此外，为最大限度的保证我司所销售产品的维修，由奥林巴斯总公司在上海和广州分别设立了两个大型维修工厂。我司将以原厂维修品质、完善的售后服务网络，为用户提供优质满意的服务。

全国咨询电话：400-820-2084。



代理商（电话、地址、联系人）

甘肃海网视讯信息技术有限公司（17794213097、甘肃省兰州市城关区南昌路6号东湖广场财智中心写字楼8层809室、齐宏伟）

现行售后服务的主要内容：（可附宣传材料）

1、设备安装调试

- 负责设备的现场安装、调试及验收
- 安排专业技术人员进行现场安装，确保设备按照规范安装到位
- 提供完整的使用培训
- 协助建立设备档案

➤货物送达采购人指定位置后由采购人明确的专人负责对货物品种、数量、规格等进行点验、接收；

➤若现场检验的时候发现设备有缺货、有缺陷、损坏、生锈或有瑕疵等情况，采购人有权拒绝接收货物同时要求更换全新的货物。

➤若采购人同意接收中标人货物时（若存在不影响实质性使用的情况下），中标人应采取必要的措施，如补充、修理或替换等，使设备处于完好状况，由此而产生的费用由中标人承担。

2、定期维护保养

➤每季度进行设备巡检，根据设备使用频率和厂家建议，制定定期维护计划，一般建议每季度进行一次巡检

➤每年进行一次全面保养

➤提供年度设备使用评估报告

➤在巡检过程中，若发现设备存在潜在问题，及时进行故障排查和修复，避免设备出现更大故障。

3、技术支持

➤提供操作使用咨询服务

➤远程故障诊断

4、培训服务

➤基础操作培训

➤高级应用培训

➤维修保养技术培训

5、维修服务

➤提供专业维修服务

➤提供备用设备租赁

➤特殊配件预定服务

6、设备运输

包装要求：设备采用防震、防潮、防尘的专业包装，确保运输过程中设备的安全。

运输方式：根据客户需求，选择专业的物流公司或自行安排运输，确保设备准时、安全送达。

售后服务技术人员简历：

奥林巴斯（北京）销售服务有限公司 兰州分公司服务团队介绍

奥林巴斯（北京）销售服务有限公司兰州分公司现有四名市场服务工程师，为甘肃省奥林巴斯用户提供设备安装、培训、设备故障现场服务、维修备品提供、维修流程跟进等服务工作，以保障设备正常运行，为客户提供安全、安心的服务保障。



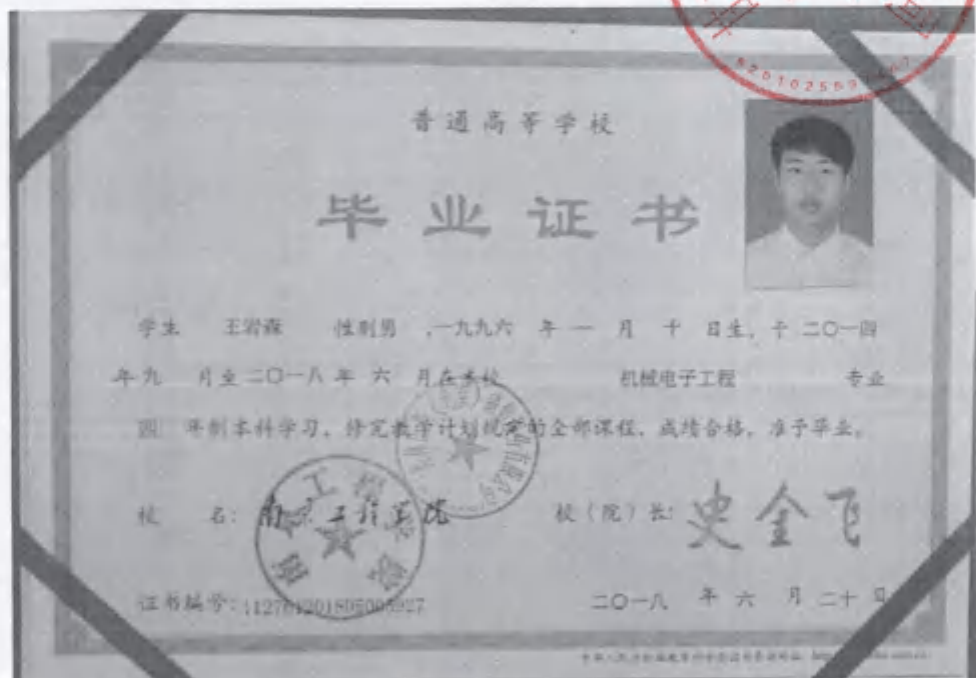
注：证书正面附二维码，可进入奥林巴斯公众号，查询人员信息、服务资质等信息，亦可查询设备维修进度，以保证设备进行原厂维修。

奥林巴斯（北京）销售服务有限公司

奥林巴斯（北京）销售服务有限公司兰州分公司
市场服务工程师名单

序号	姓名	职务	学历	联系电话	身份证号码
1	张亚虎	经理	本科	18919896915	620103197404271010
2	刘威	工程师	本科	18993198967	62230119900201239X
3	韩文忠	工程师	本科	18119469998	620423198908244331
4	王岩森	工程师	本科	15895952581	620403199601100013





投标人（盖章）：甘肃海网视讯信息技术有限公司

法定代表人或法人授权委托人签字或盖章：齐景伟

日期：2025 年 3 月 24 日

兰州大学第二医院（第二临床医学院）财务往来单位信息

单位全称	甘肃海网视讯信息技术有限公司	法人代表姓名	郝宏斌
营业证号	/	营业税号	9162 0102 0575 7660 98
银行账号	931903813210301	开户银行	招商银行兰州城南支行
授权委托人/ 经办人姓名	杨得景	授权委托人/ 经办人电话	15117079094
会计姓名	彭湘云	会计电话	18993042815
会计邮箱号	289495252@qq.com	传真	/
单位通讯地址	甘肃省兰州市城关区南昌路6号东湖广场财智中心写字楼8层809室		



中




中标通知书

中标编号: D01-1262000022433349J-20250221-054119-7/001

甘肃海网视讯信息技术有限公司:

你单位于2025年03月24日所递交的兰州大学第二医院（第二临床医学院）内窥镜项目的投标文件经评标委员会评定，确定贵单位中标，请于收到本中标通知书后30日内与采购人签订合同。具体中标内容如下：

货物名称及数量 (简要描述)	电子上消化道内窥镜（放大）1套、电子结肠内窥镜（放大）1套、电子上消化道内窥镜（普通高清）1套、电子结肠内窥镜（普通高清）1套	
中标价 (大写人民币)	1836000.00元 壹佰捌拾叁万陆仟元整	
项目业主单位： (盖章)  负责人： 2025 年 3 月 24 日	招标代理机构： (盖章)  负责人：  2025 年 3 月 24 日	甘肃省公共资源交易中心 (盖章)  交易结果 见证专用章 2025-3-26 年 月 日

- 1. 招标人或代理机构自行下载，由采购人、中标单位、代理机构分别留存。省公共资源交易中心自行下载存档。
- 2. 此件涂改无效。
- 3. 请据此办理有关手续。

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

买方（医疗卫生机构）：兰州大学第二医院

卖方（医药生产经营企业及其代理人）：甘肃海网视讯信息技术有限公司

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经买、卖双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、买卖双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、买方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定进行合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、买方严禁接受卖方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。买方工作人员不得参加卖方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向卖方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受卖方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁买方工作人员利用任何途径和方式，为卖方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为卖方统计提供便利。

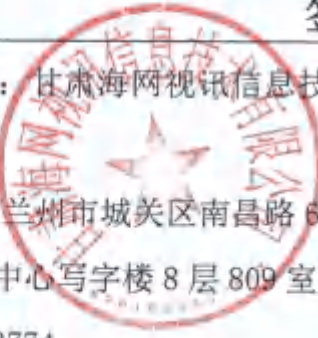
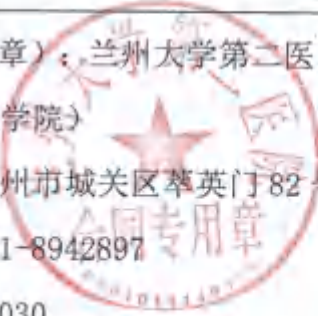




五、卖方不得以回扣、宴请等方式影响买方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、卖方指定杨得景作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到买方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到买方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、卖方如违反本合同，一经发现，买方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如卖方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》“（国卫法制发〔2013〕50号）处理”。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

签署页

卖方（公章）： 甘肃海网视讯信息技术有限公司 地址：甘肃省兰州市城关区南昌路6号东湖广场财智中心写字楼8层809室 电话：18693193774 邮编：730010	买方（公章）： 兰州大学第二医院（第二临床医学院） 地址：兰州市城关区萃英门82号 电话：0931-8942897 邮编：730030
法定代表人： 签字日期：2025 年 4 月 22 日	法定代表人： 签字日期：2025 年 4 月 22 日
委托代理人： 签字日期：2025 年 4 月 22 日	委托代理人： 签字日期： 年 月 日
经办人： 签字日期：2025 年 4 月 22 日	经办人： 签字日期：2025 年 4 月 22 日
开户行：招商银行兰州城南支行 账号：931903813210301	开户行：交通银行兰州解放门支行 账号：621060115010149088091
代理机构（公章）： 北京泛华国金工程咨询有限公司 经办人： 电话：13919050520 邮编：730030 地址：兰州市城关区和平新村127号元富大厦16楼	